

МАССАЖЕР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

Body модель BioSonic1130 Sculptor

GÉZATONE
PERFECT BODY



3 **B** **1** 

МАССАЖЕР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

GÉZATONE
PERFECT BODY

Body модель BioSonic 1130 **Sculptor**



ХОТИТЕ ИМЕТЬ
КРАСИВОЕ ТЕЛО И СТРОЙНУЮ ФИГУРУ,
ЛЕГКО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
ЛИШНЕГО ЖИРА И ЦЕЛЛЮЛИТА,
С КОМФОРТОМ
ПОДТЯНУТЬ КОЖУ,
БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ
МОДЕЛИРОВАТЬ СИЛУЕТ?

ЭТО ВОЗМОЖНО БЛАГОДАря СОВРЕМЕННОМУ ПРИБОРУ **GEZATONE BIOSONIC 1130**, В КОТОРОМ УДАЧНО СОЧЕТАЮТСЯ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

- ✓ **ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ УЗ ВОЗДЕЙСТВИЕ**
- ✓ **РАДИОЧАСТОТНАЯ ЭНЕРГИЯ («RF-ЛИФТИНГ»)**
- ✓ **ИНФРАКРАСНЫЙ ПРОГРЕВ (ХРОМОТЕРАПИЯ)**

КОМБИНАЦИЯ ТРЕХ МЕТОДИК ПОЗВОЛЯЕТ В КОРОТКИЕ СРОКИ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ЦЕЛЛЮЛИТА И ЛОКАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ ТРУДНО ПОДДАЮТСЯ КОРРЕКЦИИ С ПОМОЩЬЮ ДИЕТ И ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ.

УЗ ВОЗДЕЙСТВИЕ + «RF-ЛИФТИНГ» + ХРОМОТЕРАПИЯ


3 В 

Body модель BioSonic 1130 **Sculptor**

ТРИ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИКИ В ОДНОМ ПРИБОРЕ

УЗ ВОЗДЕЙСТВИЕ

- **ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ** помогает моделировать силуэт, способствует сокращению жировых отложений и целлюлита безопасно и эффективно.
- Высокочастотные ультразвуковые волны оказывают на жировые клетки вибрационное воздействие, в результате чего внутри них образуются и схлопываются мелкие пузырьки.
- При УЗ микромассаже расщепляются даже самые плотные жировые отложения, при этом жир выводится из организма естественным путем.
- Помимо этого, ультразвук усиливает отток жидкости из проблемных зон и ускоряет процессы выведения расщепленного жира.
- Согласно научным исследованиям, высокочастотные ультразвуковые волны действуют только на жировые клетки и не влияют на остальные ткани, поскольку они обладают большей прочностью и эластичностью, поэтому являются абсолютно безопасными.
- Уже после первой процедуры можно увидеть положительный результат.

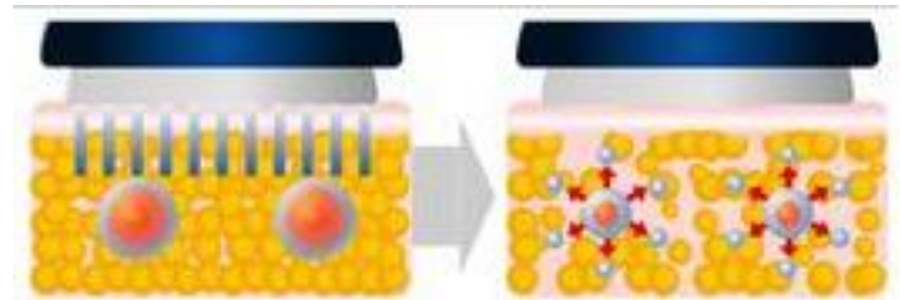

Body модель BioSonic 1130 Sculptor

ТРИ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИКИ В ОДНОМ ПРИБОРЕ

«RF-ЛИФТИНГ»

РАДИОЧАСТОТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (RF) Популярная и эффективная методика коррекции фигуры, уменьшения локальных жировых отложений, целлюлита и укрепления кожи, которая великолепно сочетается и дополняет процедуру УЗ кавитации.


- Радиочастотные волны (500кГц) воздействуют на глубокие слои кожи и подкожно-жировой клетчатки, вызывая местный разогревающий эффект, в результате которого активизируются процессы синтеза молодого коллагена. Старые коллагеновые волокна под действием тепла обретают первоначальную упругость и сжимаются, что ведет к укреплению структурного каркаса кожи, её уплотнению и подтяжке.
- Тепло, создаваемое радиоволнами, стимулирует расщепление жира и уменьшение его объема, что приводит к исчезновению или уменьшению эффекта «апельсиновой корки».
- Функция RF воздействия имеет 4 уровня: от слабого до сильного, который можно выбрать, ориентируясь на индивидуальные ощущения.



Нормальное состояние кожи



Целлюлит: увеличенные жировые клетки

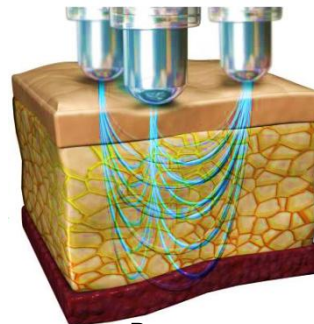

Радиочастотное воздействие RF



Прогрев внутренних слоев кожи и жировой ткани



Результат: уменьшение признаков целлюлита


Body модель BioSonic 1130 **Sculptor**

ТРИ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИКИ В ОДНОМ ПРИБОРЕ

ХРОМОТЕРАПИЯ

ИНФРАКРАСНЫЙ ПРОГРЕВ ХРОМОТЕРАПИЯ

- Для воздействия на кожу в приборе Gezatone BioSonic 1130 используется красный свет с длиной волны около 625нм.
- ИК прогрев стимулирует кровообращение и обменные процессы, усиливает выработку коллагена, укрепляет и подтягивает кожу.
- Инфракрасный прогрев оживляет биологические функции клеток, снимает боль в мышцах, выводит токсины, оказывает выраженное антибактериальное воздействие, восстанавливает и улучшает иммунитет.
- Использование хромотерапии в сочетании с УЗ кавитацией и радиочастотным воздействием позволяет получить максимальный результат, который сохраняется длительное время.

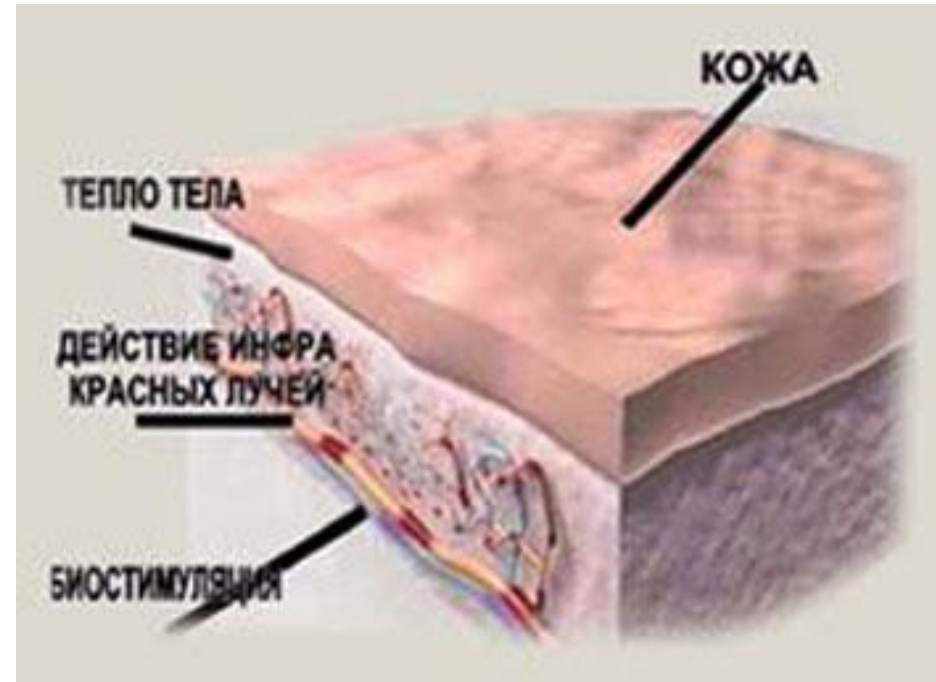

МАССАЖЕР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

GÉZATONE
PERFECT BODY

Body модель BioSonic 1130 **Sculptor**

КОМБИНАЦИИ МЕТОДИК

При использовании прибора возможно совмещать несколько комбинаций воздействия:

- УЗ воздействие + «RF-лифтинг» + хромотерапия
- «RF-лифтинг» + хромотерапия
- УЗ воздействие + «RF-лифтинг»
- УЗ воздействие + хромотерапия

УЗ ВОЗДЕЙСТВИЕ + «RF-ЛИФТИНГ» + ХРОМОТЕРАПИЯ



УЛЬТРАЗВУК

моделирует силуэт,
помогает избавиться
от целлюлита



RF ВОЗДЕЙСТВИЕ

уменьшает объемы
и жировые отложения



ХРОМОТЕРАПИЯ

повышает тонус
и улучшает внешний
вид кожи



Body модель BioSonic 1130 **Sculptor**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА

- УМЕНЬШЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА И ИЗБЫТОЧНЫХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, УМЕНЬШЕНИЕ ЭФФЕКТА «АПЕЛЬСИНОВОЙ КОРКИ»
- МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛУЭТА (ВОЗМОЖНОСТЬ ЛОКАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОЛЬКО НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ)
- КОРРЕКЦИЯ РАСТЯЖЕК
- ПОДТЯЖКА И УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ ТЕЛА
- ПОВЫШЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ И УПРУГОСТИ КОЖИ ТЕЛА



- ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА
- УЛУЧШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ
- УСТРАНЕНИЕ ОТЕКОВ
- ВЫВЕДЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ



Body модель BioSonic 1130 **Sculptor**

ПРЕИМУЩЕСТВА Gezatone BioSonic 1130

- 3 эффективные технологии для коррекции фигуры в компактном корпусе
- Абсолютная безопасность
- Видимые результаты после первого сеанса
- Эффективность не уступает профессиональным процедурам
- Прибор прост и комфортен в использовании



Арт: 1301167



Body модель BioSonic 1130
Sculptor

РЕКОМЕНДАЦИИ

Следуя рекомендациям, **ВЫ ПОЛУЧИТЕ НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

1. Интервал между процедурами должен составлять не менее 3х дней.
2. В течение дня перед процедурой рекомендуется выпить не менее 1 литра воды, а также еще не менее одного литра в течение дня после процедуры.
3. Для стимуляции лимфотока ежедневно проводите процедуры вакуумного массажа или массируйте зоны воздействия ручным массажером AMG125 Gezatone.
4. Не принимайте пищу за 2 часа до процедуры и в течение часа после.
5. Запрещено принимать алкогольные напитки в день проведения процедуры и день после неё.
6. Не рекомендуется прием кофе и продуктов с кофеином в день проведения процедуры и день после неё.
7. Не принимайте горячую ванну или душ, не посещайте сауну или баню в день проведения процедуры и два дня после неё.
8. Не рекомендуется посещать солярий и загорать на солнце во время прохождения курса коррекции фигуры с использованием прибора Gezatone BioSonic 1130.
9. По возможности, исключите жирную, копченую, острую пищу из рациона на время курса коррекции фигуры с использованием прибора Gezatone BioSonic 1130.
10. Процедуры рекомендуется проводить не менее, чем через 10 дней после приема антикоагулянтов или нестероидных противовоспалительных препаратов.

Body модель BioSonic 1130 Sculptor

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

«RF» биполярный
излучатель

Излучатель
красного света

«ВЧ»
излучатель

Разъем питания

Световое
индикаторное
кольцо

Кнопка режима
светового воздействия
(LED)

Кнопка вкл./выкл.

Кнопка режима «RF»

Кнопка режима «ВЧ»
воздействия (CV)

Блок питания



Body модель BioSonic 1130 **Sculptor**

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Общее время процедуры не должно превышать 30 минут (3 проблемные зоны, по 10 минут на каждую).
- За 1 процедуру не рекомендуется обрабатывать больше 3х проблемных зон.
- Рекомендуемое время воздействия на каждую проблемную зону – 10 минут. В приборе встроена функция автоматического отключения каждые 10 минут.
- Обрабатываемая часть тела не должна быть по размеру больше чем 30x20см.
- Во время процедуры может возникнуть ощущение тепла и небольшое покраснение кожи, которые пройдут в течение часа после окончания процедуры.
- Не используйте аппарат для проведения процедур вокруг глаз, на лице, ушах, шее, груди, в зоне декольте, лимфатических узлов, на суставах.



Body модель BioSonic 1130 **Sculptor**

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Антицеллюлитный гель для тела
Beauty Style «Ультрацелл»,
600 или 150 мл

Активный гель может применяться в процедурах УЗ микромассажа, миостимуляции и микротоковой терапии по телу. Гель имеет активную формулу, которая уменьшает жировые отложения и целлюлит.



Коктейль моделирующий
антицеллюлитный Mesoderm,
5мл (упак. 10шт)

Концентрированный коктейль для уменьшения объемов тела, устранения «апельсиновой корки», коррекции целлюлита и уменьшения избыточных жировых отложений. Формула коктейля включает эффективные компоненты, которые разработаны для коррекции фигуры.



Тонизирующий гель для тела
Beauty Style «Ультрафирм»,
600 или 150 мл

Активный гель может применяться в процедурах УЗ микромассажа, миостимуляции и микротоковой терапии. Гель тонизирует и укрепляет кожу, предотвращает появление растяжек и уменьшает дряблость кожи.



Контактный гель Beauty Style для
процедуры лазерной и
RF-коррекции кожи

Гель для проведения аппаратных процедур лазерной и RF-коррекции кожи повышает эффективность омолаживающих и корректирующих процедур, минимизирует возможную реакцию кожи на воздействие, являясь великолепным контактным косметическим средством.

Body модель BioSonic 1130 Sculptor

ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРИБОРА

- Забудьте о дорогостоящих процедурах в Салонах красоты! С прибором Gezatone BioSonic 1130 Вы сможете делать полноценные косметологические процедуры для тела самостоятельно и не выходя из дома.
- Количество изнурительных тренировок в фитнес-центре можно смело сократить. Теперь за стройностью Вашего силуэта и объёмами тела будет следить прибор Gezatone BioSonic 1130.
- Два раза в неделю по 30 минут в день приятных процедур в комфортных домашних условиях позволит Вам сэкономить не только деньги, но и время, а достигнутые результаты Вас приятно удивят.
- Гладкая, подтянутая кожа, великолепная фигура, стройная талия и ни какого целлюлита - разве не об этом мечтает каждая женщина? Мечты сбываются! С прибором Gezatone BioSonic 1130 Ваша фигура приобретет желаемые формы и Вы сможете сохранить и поддержать полученный результат надолго.
- Восторженные взгляды подруг на Вашу стройную фигуру придадут Вам уверенности в себе.
- Вы сэкономите деньги, но Вам придется их потратить на новую одежду, потому что старая Вам будет слишком велика.



Body модель BioSonic 1130
Sculptor

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Беременность и период лактации
- Онкологические заболевания
- Почечная недостаточность, желчекаменная болезнь, печеночная недостаточность, гепатит
- Сахарный диабет
- Эпилепсия
- Наличие кардиостимулятора
- Заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь
- Варикоз и сосудистая сетка в области воздействия, нарушения свертываемости крови
- Наличие металлических штифтов и имплантатов в зоне обработки («золотые» нити, силикон, филеры, внутриматочная спираль и др.)
- Миома матки
- Нарушение целостности кожных покровов в месте обработки, ожоги, раны
- Склонность к образованию келоидов
- Заболевания соединительной ткани (склеродермия, системная красная волчанка и др.)
- Нарушение кожной чувствительности
- Хронические дерматиты и дерматозы в стадии обострения, акне в стадии обострения
- Прием дерматропных препаратов (например, «Роаккутан»)
- Острые инфекционные и вирусные заболевания, грипп, ОРВИ, повышенная температура
- Детский или подростковый возраст

Body модель BioSonic 1130 **Sculptor**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наименование: BioSonic 1130 Прибор для ухода за кожей Gezatone
- Артикул: 1301167
- Входное напряжение: AC100-240V
- Выходное напряжение: DC12V 2A
- Параметры ультразвука: частота 330кГц
- Параметры RF: частота 500кГц
- Параметры светового излучения: длина волны 625нм.
- Вес: 259г
- Размер: 114x90x100 мм
- Размер в упаковке: 195x150x98 мм
- ШК 3004564029795
- Гарантия: 1 год. Срок службы: 5 лет.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

Москва 8 (495) 120-10-80

регионы РФ: 8-800-500-95-94 (звонок бесплатный)

WWW.SOZV.RU

Присоединяйтесь:



www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty



facebook.com/sozvezdiekrasoti



vk.com/sozvezdiekrasoti

GÉZATONE
PERFECT BODY